

Dotyczy: postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego użytku (część I) i/lub materiałów opatrunkowych (część II).

DLA : Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

Pakiet 1 – strzykawki i igły, poz. 1-3, 7, 8-19

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowania strzykawek/igieł a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.


Pakiet 1 – strzykawki i igły, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowania strzykawek 20 ml a'80 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 80 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pakiet 1 – strzykawki i igły, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji strzykawki cewnikowej innego producenta, spełniającej wymagania SIWZ i tożsamej ze strzykawką producenta Polfa, jak poniżej:

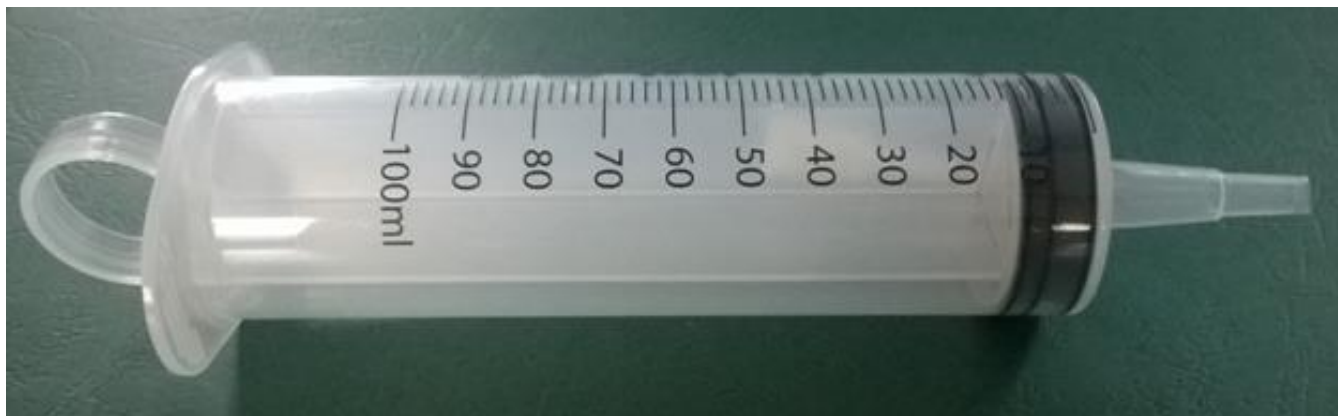

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji strzykawki innego producenta posiadającej podane parametry jeśli będzie ona tożsama ze strzykawką producenta POLFA. Wymagamy: gumowy tłok przesuwający się równomiernie z umiarkowanym oporem. Oferent powinien dołączyć do oferty próbkę tego produktu (1 sztuka) jeśli oferuje strzykawkę innego producenta niż POLFA.

Z poważaniem
Joanna Komorowska
Dyrektor SPZOZ w Żukowie